

## Erratum zur Abbildung 22 im Jahresbericht Qualitätssicherung 2019

Im Jahresbericht Qualitätssicherung 2019 wurde fälschlicherweise in Abbildung 22 die durchschnittliche mittlere Parenchymdosis in Abhängigkeit der simulierten komprimierten Brustdicke bei jährlichen Konstanzprüfungen des Jahres 2020 anstelle der Daten aus 2019 veröffentlicht. Die korrekte Darstellung der durchschnittlichen AGD der jährlichen Konstanzprüfungen des Jahres 2019 ist wie folgt:

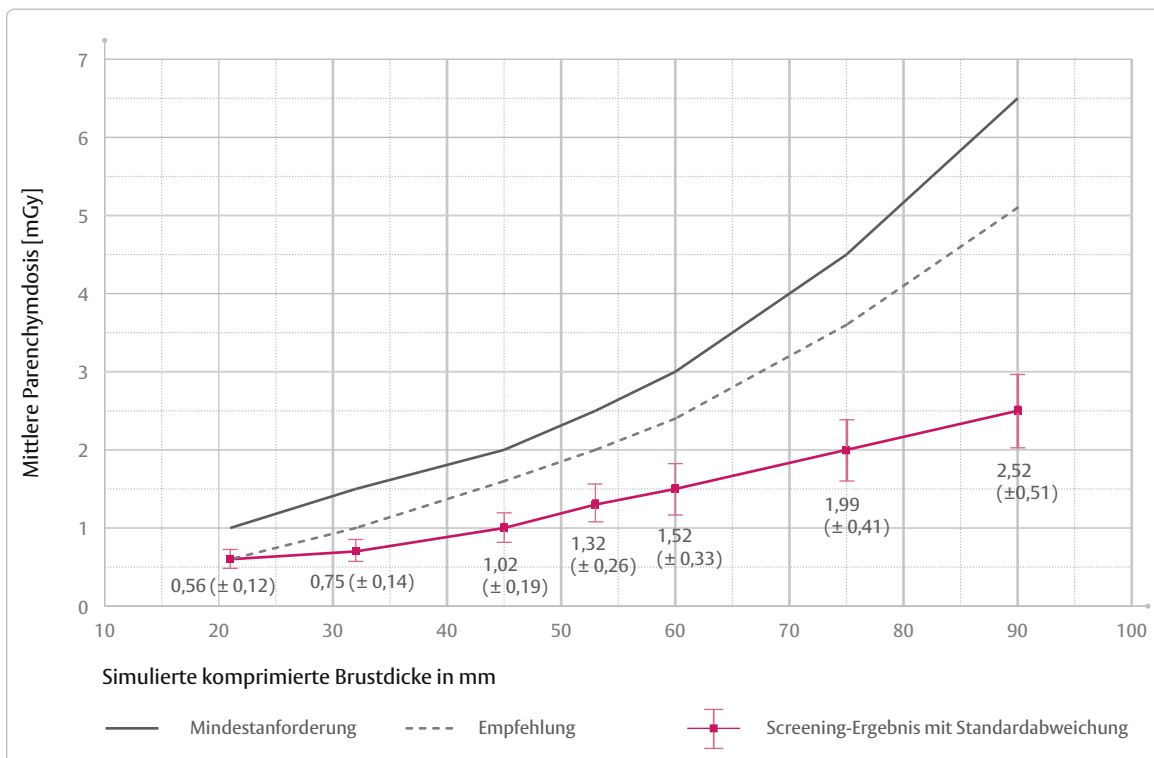


Abbildung 22: Durchschnittliche mittlere Parenchymdosis in Abhängigkeit der simulierten komprimierten Brustdicke bei jährlichen Konstanzprüfungen eingesetzter Mammographie-Systeme 2019